

















Usinage de l'intérieur d'implant dentaire

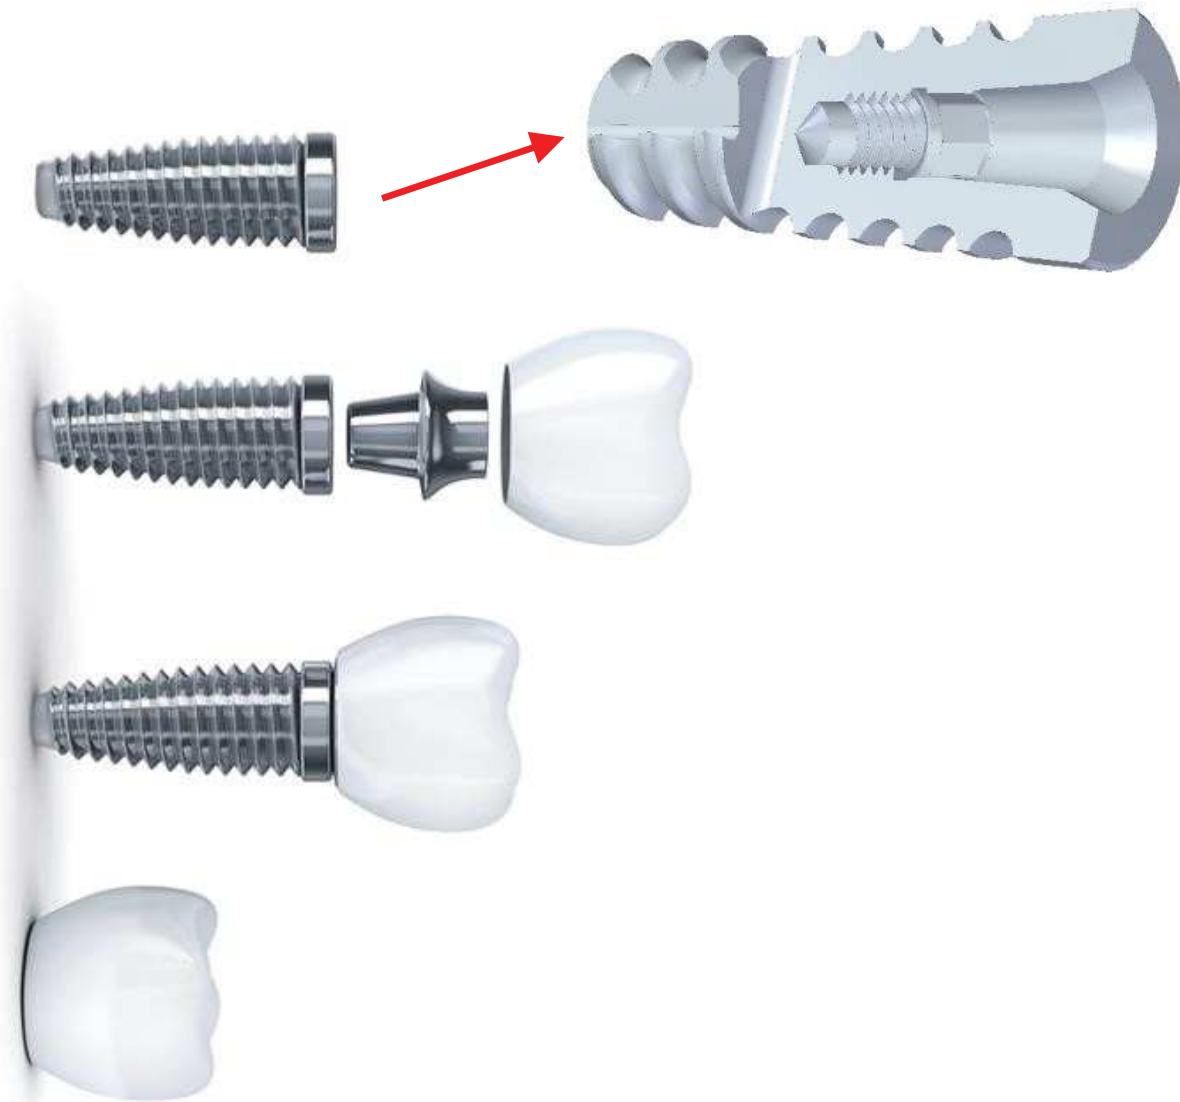

1.  **DRP-foret centreur** 
2.  **DRA-foret haute performance** 
3.  **Grain d'alésage SDG** 
4.  **Grain de rainurage SDS** 
5.  **Fraise à tourbillonner WHC** 
- 5a.  **Fraise à tourbillonner WHS** 
6.  **Poinçon BRH** 
- 6a.  **Poinçon BRT** 